


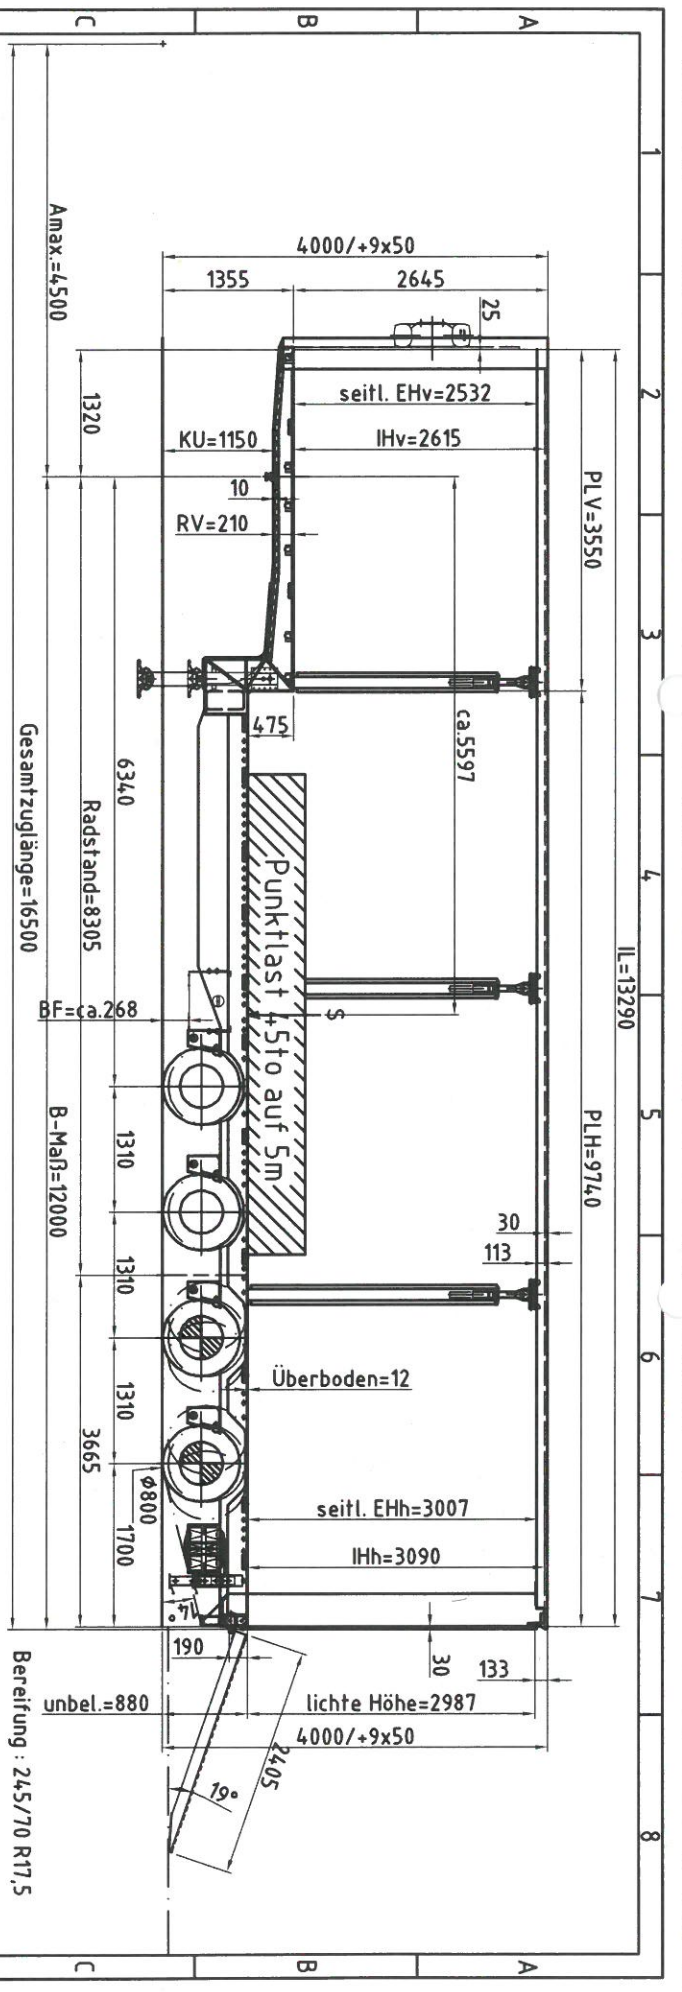

Sehr geehrter Herr Franz,
ich bitte um eine Bestätigung der Ausführung.

Mit freundlichen Grüßen
Reinhard Michl
Technischer Leiter

- ① Zurringe 13,4 to
- ② Zurringe 13,4 to; überklappbar
- ③ Zurringe 4 to
- ④ Rungentaschen für Rungen 100x50 mm

[illegible]